

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, дом 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

10.06.2014

№ 10/5

На № _____

от _____

Поставщикам, заинтересованным в
поставке Товара



От:

Федеральное государственное
автономное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита) ФГАНУ «ФНЦИРИП
им. М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус
1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческого предложения



ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки запасных частей для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

№ п/п	Наименование Товара*	Характеристики Товара*	Ед. изм.	Кол-во
1.	Пневмоостров Multipol Joucomatic	Code: CMU300Q0G108 Сер. Номер: 4637 3L7 Pe: 1,5-8 bar Un: 24V В комплекте: - Пневмораспределитель ASCO JOUCOMATIC 57000014 – не менее 3 шт. - Пневмоклапан ASCO JOUCOMATIC 57000053- не менее 6 шт. Образец:	шт.	1

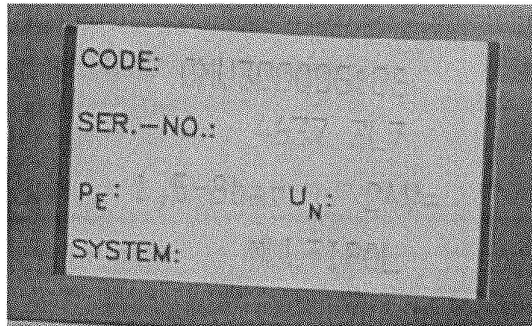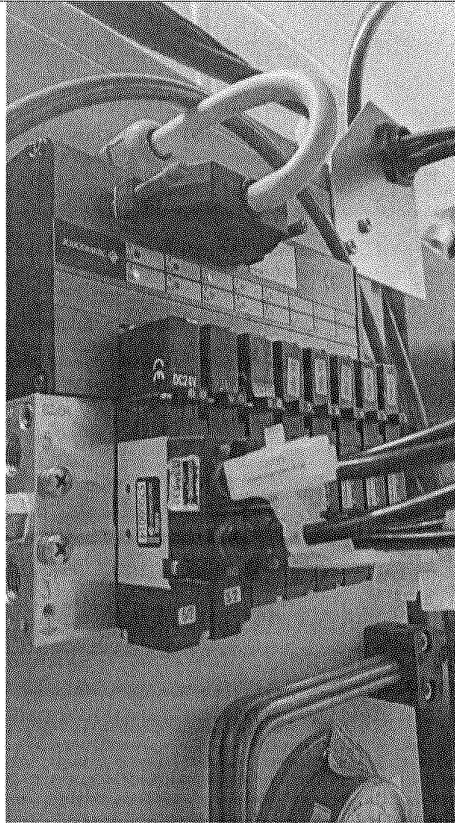

Запасная часть для оборудования: Сушка лиофильная, инв. № 00-009539

	<p>2. Прецизионный регулятор давления MS6-LRP-1/2-D2-A8 с манометром FESTO 161126 MAP-40-1-1/8-EN, Артикул: 538023</p>	<p>Наименование: Регулятор давления прецизионный Серия товара: MS6-LRP или эквивалент Тип рукоятки: Поворотная рукоятка с фиксацией Тип управления: Ручное Тип действия: Пилотный Присоединение: 1/2 Максимальный гистерезис давления: 0,02 бар Диапазон регулировки давления: От 0,05 до 2,5 бар Расход, сброс: \geq 450 л/мин Максимальный стандартный расход: 2300 л/мин Постоянная выходного давления: Со вторичным сбросом Тип конструкции: Мембранный Тип присоединения на входе: внутренняя резьба Тип крепления: Установка передней панели. Линейный монтаж. С принадлежностями Монтажный шаг: 62 мм Присоединение манометра: 1/8 Тип резьбы: G Ширина: 62 мм Высота: 214 мм Длина: 78,5 мм Материал корпуса: Алюминий Материал уплотнения: NBR (Бутадиен-нитрильный каучук)</p>	шт.	2
--	--	--	-----	---

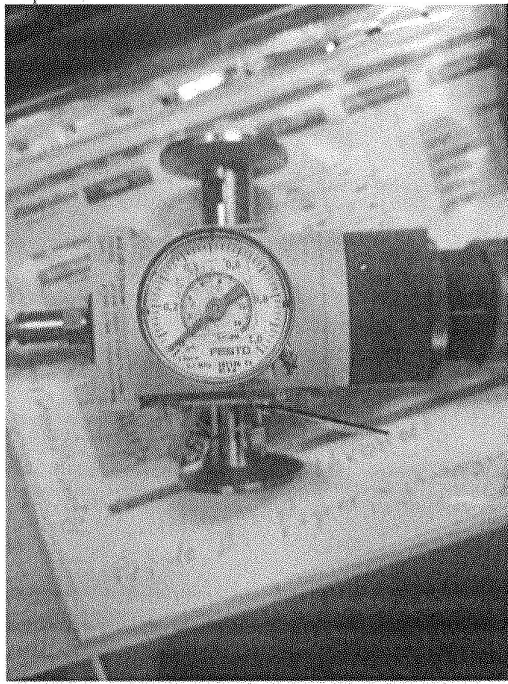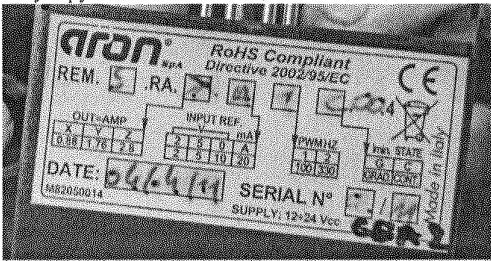		<p>Максимальное рабочее давление: 14 бар Положение при сборке: Любое Рабочая среда: Сжатый воздух, инертные газы Рабочая температура: От -10 до +60 °C Манометр: FESTO 161126 MAP-40-1-1/8-EN или эквивалент Класс точности: 1,6 Диапазон индикации: От 0 до 1 бар Фактор переменной нагрузки: 0,66 Номинальный размер манометра: 40 мм Присоединение манометра: 1/8 Образец:</p>  <p>Запасная часть для оборудования: Сушка лиофильная SMART LYO SL150 D, инв. № 00-012311, Сушка лиофильная, инв. № 00-012248</p>		
3.	<p>Цифровой усилитель Марка: Aron</p>	<p>Код: Rem.S.RA.XA2C004 Регулирующий клапан с одним соленоидом</p>  <p>Запасная часть для оборудования: Сушка лиофильная SMART LYO SL150 D, инв. № 00-012311, Сушка лиофильная, инв. № 00-012248</p>	шт.	2

Срок поставки: в течение 120 (ста двадцати) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

Место поставки Товара: 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, дом 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: 2024 г.

Требования к качеству и безопасности товаров:

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным нормативными документами, действующими в Российской Федерации.

Порядок поставки и приемки Товара

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности,

санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией, а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

Порядок оплаты: не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, аванс не предусмотрен.

В стоимость товара включается:

В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий:

На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несёт Поставщик.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «10» 06 2024 г. по «15» 06 2024 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

С уважением,

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)


А.Ю. Афонин