

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, дом 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

14.08.2024

№ 14/2

На № _____

от _____

Поставщикам, заинтересованным в
поставке Товара

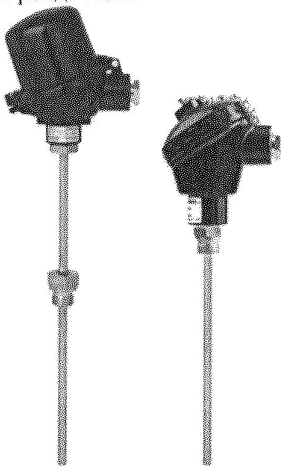
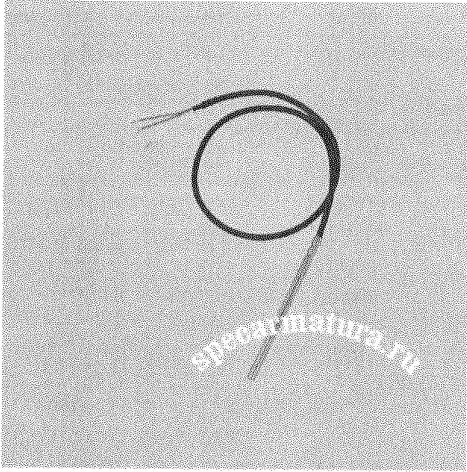
От:

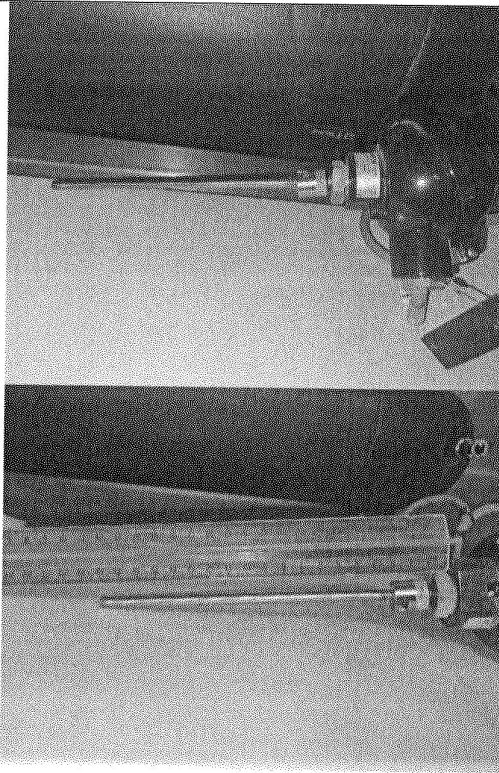
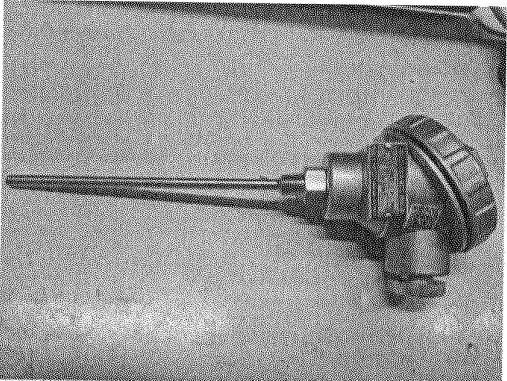
Федеральное государственное
автономное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита) ФГАНУ «ФНЦИРИП
им. М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус
1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки запасных частей для производственного оборудования нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

№ п/п	Наименование Товара	Характеристики Товара	Ед. изм.	Кол-во
1.	Гидрофобный фильтрующий картридж Sartofluor GA 5185507T1	Арт.: 5185507T1 Мембрана: PTFE Поддерживающее волокно: Полипропилен Сердцевина: Ацетат целлюлозы Концевые крышки: полипропилен <u>Запасная часть для оборудования: Сушка лиофильная SMART LYO SL150 D, инв. № 00-012311, Сушка лиофильная, инв. № 00-012248</u>	шт.	4
2.	Датчик температурный PT-100 TR 40 (-50+250) C Артикул: 45280444	Номенклатурный номер:8031013726 1xPt100, 3-проводный Выходной сигнал: Pt100 Материал погружаемой части: Сталь нержавеющая Диаметр гильзы: 6 мм Кабельный ввод: Стандартный кабельный ввод Размер резьбы кабельного ввода: M20 x 1,5 Датчик: Без клеммной колодки Защитная трубка: Прямая, гладкая, с компрессионным фитингом / без него Соединение с горловиной трубки: M24 x 1,5 Технологическое присоединение: компрессионный фитинг G 1/2 B (металлический наконечник) Длина вставки [A] [U1]: 100 мм	шт.	2

		<p>Бренд: Wika</p>  <p>Запасная часть для оборудования: «Шкаф сушильно-стерилизационный ШССц-1000л с/н 41», инв.№ 10134001751, «Шкаф сушильно-стерилизационный ШССц-1000л с/н 13», инв. № 10134001752, «Шкаф сушильно-стерилизационный ШССц-1000л с/н 130», инв. № 10134001753</p>		
3.	<p>Датчик температурный PT-100 TR 40 (-50+250) C Артикул: 36837185</p>	<p>Производитель: WIKA Тип изделия: Термометр сопротивления трехпроводный Диаметр зонда, мм: 6 Диапазон измерения температуры, С: от -50 до +250 Выходной сигнал: Pt100 Материал кабеля: ПТФЭ Материал погружаемой части: Сталь нержавеющая Длина погружаемой части, мм: 300</p>  <p>Запасная часть для оборудования: Сушка сублимационная ТГ-50, инв. № 00-009044</p>	шт.	2
4.	<p>Датчик температурный PT-100 TR 10-D</p>	<p>Производитель: WIKA Тип изделия: Термометр сопротивления Диапазон измерения температуры, С: от -50 до +250 Выходной сигнал: Pt100 Материал погружаемой части: Сталь нержавеющая Длина: 180 мм Присоединение к процессу: Измерительная вставка с пружинным поджатием Диаметр гильзы: 6 мм</p>	шт.	2

					
5.	Датчик температурный	<p>Выходной сигнал: PT-100 Диапазон измерения температуры: от -50 до 250 °С Диаметр гильзы, мм: 6 Длина штока, мм: 50 Присоединение: ½”</p> 	<p>Запасная часть для оборудования: Сушка лиофильная SMART LYO SL150 D, инв. № 00-012311, Сушка лиофильная, инв. № 00-012248</p>	шт.	2
		<p>Запасная часть для оборудования: «Машина для сублимационной сушки вакцин, Производитель: ilShin Bio Base Co. Ltd.», инв. № 10124000215, «Машина для сублимационной сушки вакцин, Производитель: ilShin Bio Base Co. Ltd.», инв. № 10124000216</p>			

Срок поставки: в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

Место поставки Товара: 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, дом 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: 2024 г.

Требования к качеству и безопасности товаров:

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным нормативными документами, действующими в Российской Федерации.

Порядок поставки и приемки Товара

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией, а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

Порядок оплаты: не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, аванс не предусмотрен.

В стоимость товара включается:

В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий:

На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несёт Поставщик.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «14» 08 2024 г. по «16» 08 2024 г. включительно по адресу: unto@chumakovs.su. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

С уважением,

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)


А.Ю. Афонин